

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»
(ФБУ «Ростест-Москва»)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ RA.RU.311320

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ АБ 0188089

Действительно до 15 сентября 2022 г.

Средство измерений Аппарат испытания диэлектриков

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в

АИД-70 М Госреестр № 34031-07

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 703

в составе _____

номер знака предыдущей поверки _____

поверено В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с «Аппарат испытания диэлектриков «АИД-70 М».

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки». ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», 2007 г.

с применением эталонов: 3.1.ZTT.2320.2018

при следующих значениях влияющих факторов: _____

Атмосферное давление: 758 мм рт.ст.; Напряжение сети: 223 В;

Относительная влажность: 58 %; Частота: 50 Гц

Температура воздуха: 20 °С;

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

пригодным к применению.

Начальник отдела Крысанов Игорь Юрьевич

должность руководителя подразделения

подпись

фамилия, имя и отчество (при наличии)


МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

(заполняется при наличии соответствующих требований в нормативных документах по поверке)

принадлежит ООО «СОДЕЙСТВИЕ»

ИНН: 5007045225

наименование юридического (физического) лица, ИНН

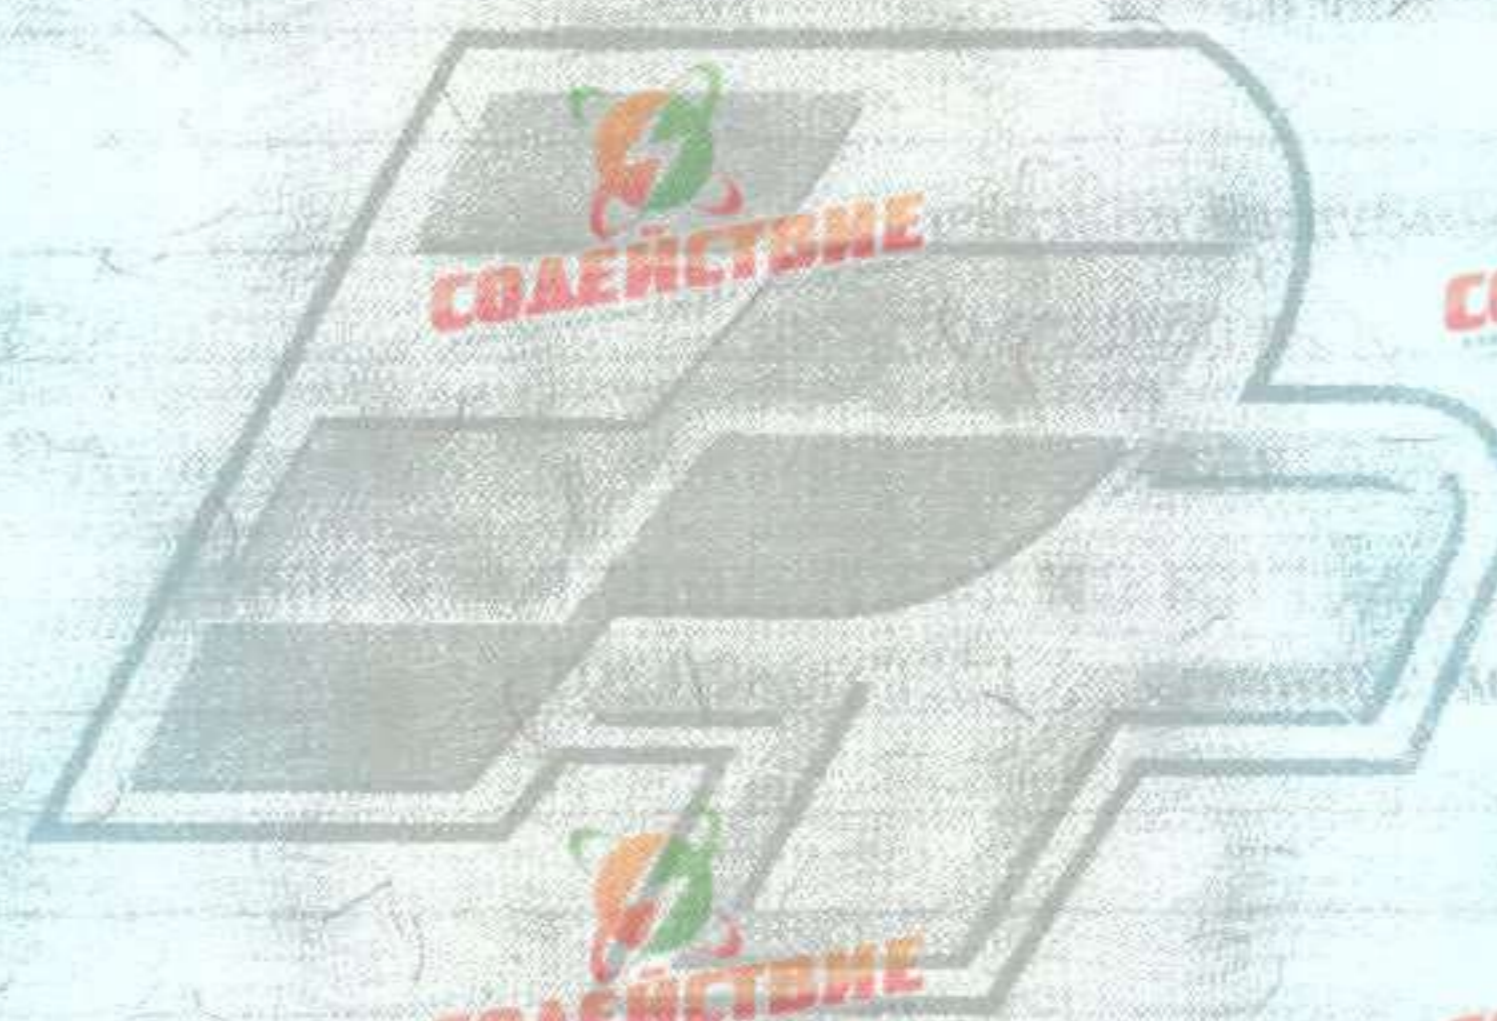

117418 Москва, Нахимовский пр., 31
Call-Центр: 495-544-00-00
тел. 499-129-19-11 факс: 499-124-99-96
Email: info@rostest.ru, www.rostest.ru