




ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

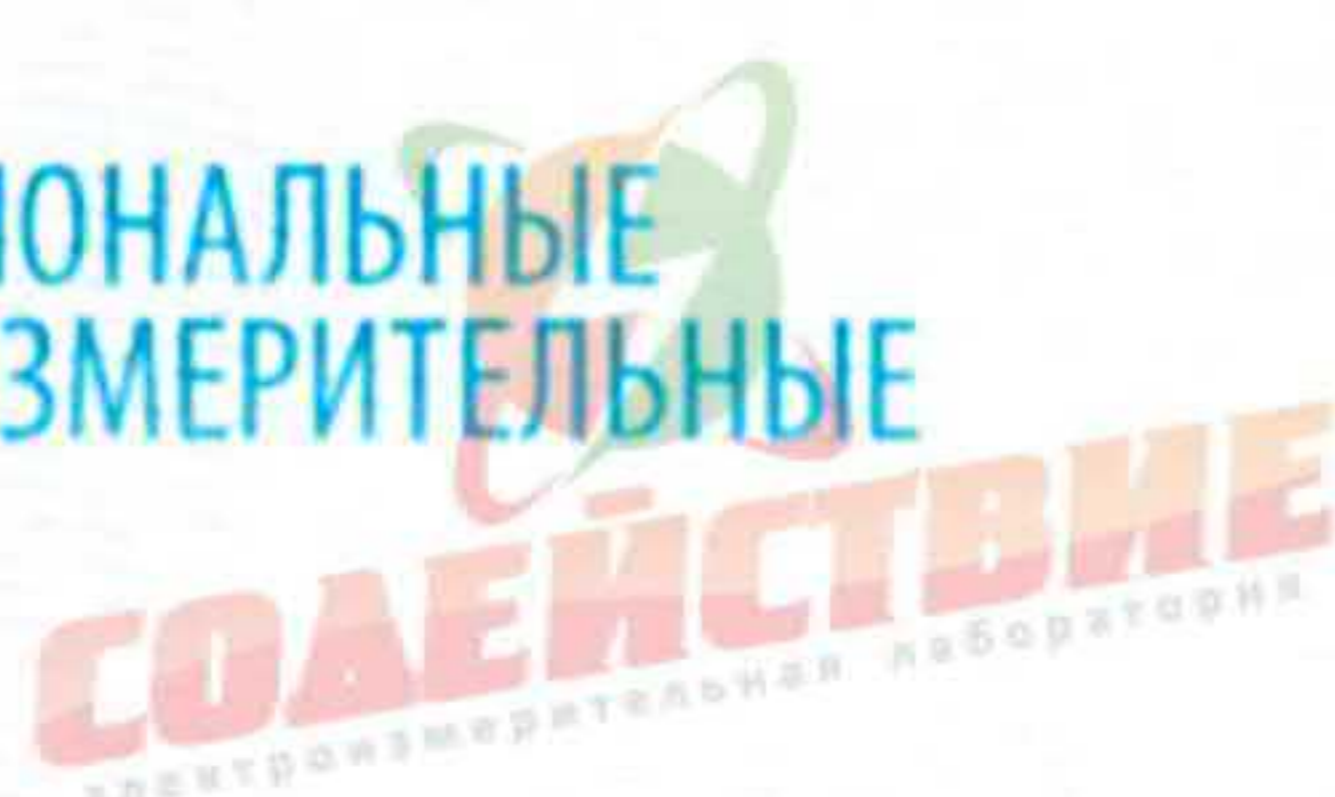

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ООО «СОНЭЛ»

Общество с ограниченной ответственностью "СОНЭЛ"
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц № 1201

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 29616-А

Действительно до 20 июля 2021 г.

**Средство измерений: Измеритель параметров
электробезопасности электроустановок MPI-525, 44170-10**

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер **A90949**
в составе -----

номер знака предыдущей поверки -----
поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с **MPI-525-09 МП**

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

**3.2.VVO.0002.2015 3.2.VVO.0003.2015 3.2.VVO.0013.2015 3.2.VVO.0014.2015
3.2.VVO.0016.2015 3.2.VVO.0017.2015 3.2.VVO.0038.2018 3.2.VVO.0040.2019**

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов **темп. возд. 22,4 °С; относ. вл. 48,2 %;**
приводят перечень влияющих факторов.

атм. давл. 89,6 кПа; напр. ф-н 234,1 В; напр. ф-ф 405,2 В; частота 50 Гц; коэф. гарм. 1,9 %.
нормированных в документе на методику поверку, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки:



Руководитель МС
должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

Барчук В.Н.

Поверитель

Михайлова И.В.

Дата поверки **21 июля 2020 г.**